

EZ-1131/2-PN/52-2014

Rybnik, dnia 24.09.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki
(zamówienie nr EZ-1131-PN/52-2014)
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 21.08.2014 r., nr 2014/S 159-285662

UWAGA – PONIŻSZE ZAPISY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WSKAZUJĄ, W JAKI SPOSÓB WYKONAWCA MA SPORZĄDZIĆ OFERTĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAŚNIEN I MODYFIKACJI UJĘTYCH W NINIEJSZYM PIŚMIE.

Zamawiający zmodyfikował formularze cenowe dla pakietów nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 24 oraz 27 dlatego sporządzając ofertę należy się posłużyć zaktualizowaną wersją tych formularzy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „pakiet 11: Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych najwyższej jakości w zakresie całego zadania (pozycje 1,2,3,4,5,6,7), prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie również:

W pozycji 3 – rampa trój-kranikowa: rampy spełniające wszystkie wymagania techniczne SIWZ dostępne w wersji ON oraz OFF do wyboru (dodatkowy atut), z ergonomicznym uchwytem typu <<half-body>>, opcjonalnie z drenem (dodatkowy atut wyboru rampy w zależności od procedury: z drenem/bez drenu z luer lock rotacyjnym) o wytrzymałości – wciąż wysokociśnieniowej – 500psi. Pragniemy podkreślić że rampy te są z powodzeniem stosowane w kilkudziesięciu pracowniach hemodynamicznych na polskim rynku, w tym Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie, Katowicach, Toruniu, Zgorzelcu, Nowej Soli, Szczecinie, Warszawie i wielu innych placówkach hemodynamicznych na terenie kraju.”

Pytanie 2: „pakiet 11: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na pytanie nr 1 dot. pakietu 11 powyżej, prosimy o wydzielenie blokującej pozycji nr 3 z całości pakietu nr 11. Zamawiający na pewno nie miał zamiaru łamać uczciwej konkurencji. Niestety w obecnym brzemieniu SIWZ na cały sprzęt jednorazowego użytku (który nie musi być zakupywany od jednego producenta) do zadania całościowego nie mogą przystąpić inne firmy, z pewną stratą finansową dla Szpitala w postaci zawyżonych cen jednostkowych netto.”

Odpowiedź 1-2: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów, tj. ustala poniższe brzmienie ww. pozycji: „Rampa trzykranikowa wysokociśnieniowa, odporna na ciśnienie minimum 500 PSI, wykonana z przezroczystego materiału (...)” W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765

niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” nanieść stosownie skorygowane zapisy.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 Stenty uwalniające lek – ewerolimus lub pochodny i nieznacznie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne maksymalnie 11 atm. Dla skrajnych rozmiarów, oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?”

Odpowiedź 3: Parametry opisane w pytaniu nie są sprzeczne z wymaganiami zamawiającego – zamawiający nie zmienia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu (nie stawia wymagań dla ciśnienia nominalnego w zakresie skrajnych rozmiarów).

Pytanie 4: „Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 9 Cewniki balonowe półpodatne o następujących parametrach?

– Długości balonowe: 6mm, 8mm i 20mm dla średnic 1,20mm-4,00mm; 12mm i 15 mm dla średnic 1,2mm – 5,0mm; 25mm i 30mm dla średnic 2,00mm – 4,00mm.

– Shaft poroksymalny: 2,1F”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 16 Stent biodegradowalny uwalniający lek o nieznacznie zmienionych parametrach: długości: 12mm, 18mm i 28mm dostępnych w średnicach 2,5mm, 3,0 i 3,5mm, oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytania od 6 do 8 dotyczą pakietu nr 22 „Kopułki do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią”

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści kopułki do pomiaru ciśnień metodą krwawą zawierające: linię pojedynczą, urządzenie płuczące (skrzydełko + wypustka), biretę kroplową, połączenie bezpinowe przetwornika z przewodem połączeniowym kompatybilnym z przewodem typu Edwards, utrzymujące stały przepływ 3 ml/h, długość linii 155 cm (130 cm + 25 cm)? Przy użyciu Użytkownik będzie miał możliwość odłączenia linii płuczącej.”


Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści kopułki do pomiaru ciśnień metodą krwawą z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym typu Edwards?”

Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści kopułki do pomiaru ciśnień metodą krwawą zgodnie z poniższym schematem (załącznik nr 1)?”

Załącznik nr 1

Odpowiedź 6-8: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie tego pakietu. Aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dowolnego asortymentu zgodnego z aktualnym opisem.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

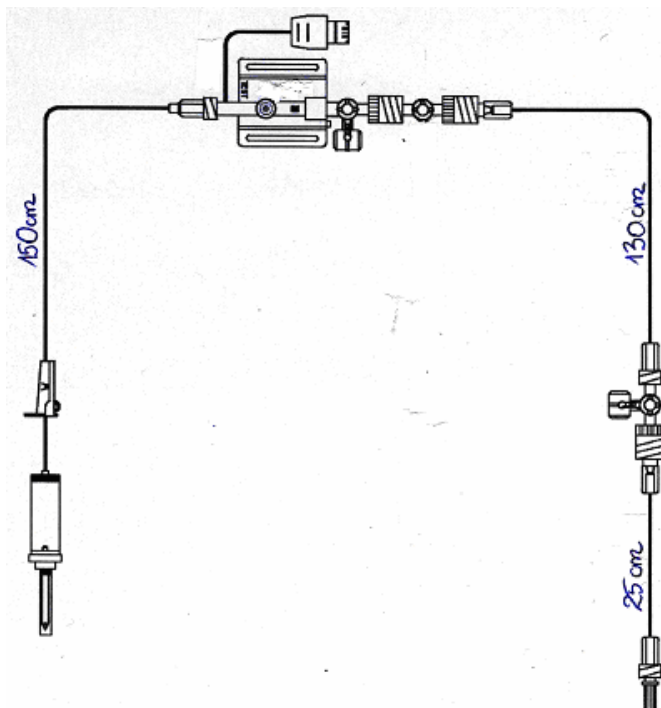

Pytanie 9: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 stentu kobaltowo-chromowego wykonanego w technice sinusoidalnej, z pojedynczego elementu łączonego laserowo; pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 10: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 cewnika balonowego o dostępnych długościach balonu: 6 mm (dla średnic 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm), 9 mm (dla średnic 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm), 12 mm (dla średnic 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm), 15 mm (2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm), 21 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm); pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 11: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 cewnika o długości 140 cm dla wersji 6F oraz 145 cm dla wersji 7F; pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 12: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 8 stentu o profilu przejścia 0,041” dla średnicy 3,0 mm; o dostępnych średnicach (długościach):

- 2,25 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 2,50 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 2,75 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 3,00 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
 - 3,50 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
 - 4,00 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
- pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 13: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 cewnika balonowego o ciśnieniu RBP balonu od 12 do 14 atm; o dostępnych średnicach (długościach):

- 1,25 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20 mm);
 - 1,50 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20 mm);
 - 2,00 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm);
 - 2,25 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20, 25 mm);
 - 2,50 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm);
 - 2,75 mm (długości: 6, 12, 15, 20, 25, mm);
 - 3,00 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm);
 - 3,25 mm (długości: 12, 15, 20 mm);
 - 3,50 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm);
 - 3,75 mm (długości: 12, 15, 20, mm);
 - 4,00 mm (długości: 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm);
- pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 4 dokonał już modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla ww. pakietu – jego aktualne brzmienie (uwzględniające odpowiedź na niniejsze pytanie) określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 14: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10 stentu o dostępnych średnicach (długościach):

- 2,25 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 2,50 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 2,75 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 3,00 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
 - 3,50 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
 - 4,00 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
- pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 15: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13 cewnika balonowego balonowego o ciśnieniu RBP balonu od 12 do 14 atm; pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 16: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 15 stentu o dostępnych średnicach (długościach):

- 2,25 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 2,50 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 2,75 mm (długości: 8, 12, 14, 18, 22, 26, 30 mm);
 - 3,00 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
 - 3,50 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
 - 4,00 mm (długości: 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm);
- pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 17: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 27 mikrocewnika o taperowanym szafcie o średnicy proksymalnej 2,8F i dystalnej 2,6F; pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź 17: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu – jego aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy się posłużyć zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 18: „Czy w zakresie Pakietu nr 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników do aspiracji skrzeplin zbrojonych podwójnym opłotem stalowym na długości 123,5cm z powłoką hydrofilną na długości 15cm w części dystalnej w jednym rozmiarze 5,1F kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F w zestawie z dwoma blokowanymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawką zamykającą w zestawie do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 0,045”; powierzchni ekstrakcyjnej dystalnej wynoszącej 0,95mm² umożliwiającej przepływ podczas ekstrakcji powyżej 102cc/minutę?”

Odpowiedź 18: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 19: „Dotyczy pakietu nr 22: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane w Pakiecie 22 Kopułki do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią Zamawiający wymaga zaoferowania standardowych przetworników do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią czy specjalnych linii dedykowanych do urządzenia Axiom Sensis prod.Siemens z membraną z tyłu obudowy przetwornika?”

Odpowiedź 19: Zgodnie z odpowiedzią na pytania 6 – 8 zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie tego pakietu. Aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 20: „*Dotyczy pakietu nr 23: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy cewnik do termodylucji amerykańskiego producenta w rozmiarach 7F i 8F zamiast 6F jak jest w wymaganiach SIWZ ?*”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 21: „*Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: <<Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości umowy, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.>>*”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 22: „*Dotyczy: SIWZ, rozdział II, wzór umowy, par. 2 ust. 1, formularz oferty pkt. 4 Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.*”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 23: „*Dotyczy: wzór umowy, par. 3 ust. 3 Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w ww. ustępie, na 5 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych, aby Wykonawca mógł zdążyć sprowadzić dla Zamawiającego brakujący towar od producenta.*”

Odpowiedź 23: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 24: „*Dotyczy: wzór umowy, par. 2 ust. 5 Prosimy o wykreślenie z w/w ustępu zapisu o treści: <<[...] i Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w §5 ust. 1.>>. Pozostawienie tego zapisu powoduje podwójne naliczenie kary za to samo przewinienie – opóźnienie w dostawie.*”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 25: „*Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1 Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości niedostarczonej partii dostawy brutto za każdy dzień zwłoki. Obecne kary są nadmiernie wygórowane i wskazują na nierówne traktowanie stron, tym bardziej, że w umowie brak jest zapisów dotyczących kar obowiązujących Zamawiającego z tytułu nieterminowych płatności.*”

Odpowiedź 25: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w § 5 ust. 1 poprzez zastąpienie obecnego brzmienia tego ustępu poniższym:

„Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.”

Pytanie 26: „*Dotyczy: wzór umowy, par. 10 Prosimy Zamawiającego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o zmianę każdego występującego sformułowania <<zgody Zamawiającego>> na <<zgody podmiotu tworzącego>>.*”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 27: „*Dotyczy: wzór umowy, par. 10, ust. 4 Wnosimy o wykreślenie w/w zapisów. Kary w nich przewidziane są bardzo wysokie i niewspółmierne z przewinieniem Wykonawcy. Kary te są również niesprawiedliwe i w różny sposób traktują wykonawców (Wykonawca, który złoży*

ofertę na kwotę 50 000,00 zł może zostać wezwany do zapłaty kary w wysokości 1 000,00 zł, natomiast inny, którego oferta wynosi 50 001,00 zł już 5 000,00 zł). Dodatkowo w umowie brak jest zapisów dotyczących kar obowiązujących w przypadku nieterminowej płatności.”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 28: „**Pakiet 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu na bazie stopu platynowo-chromowego (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi?”

Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 9 dokonał już modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla ww. pakietu – jego aktualne brzmienie (uwzględniające odpowiedź na niniejsze pytanie) określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 29: „**Pakiet 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu na bazie stopu platynowo-chromowego (PtCr) o profilu przejścia dla 3.0mm max. 0.040” oraz o możliwości skrócenia stentu po rozprężeniu nie więcej niż 3%?”

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 12 dokonał już modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla ww. pakietu – jego aktualne brzmienie (uwzględniające odpowiedź na niniejsze pytanie) określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 30: „**Pakiet 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów o ciśnieniu RBP 14 atm dla 2.25-3.25, 12 atm dla 1.50-2.00 i 3.50-4.00 ?”

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 4 i 13 dokonał już modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla ww. pakietu – jego aktualne brzmienie (uwzględniające odpowiedź na niniejsze pytanie) określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 31: „**Pakiet 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu na bazie stopu platynowo-chromowego (PrCr) – zawartość platyny 33% wagi?”

Odpowiedź 31: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 32: „**Pakiet 13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów o ciśnieniu RBP 14 atm?”

Odpowiedź 32: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu.

Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy się posłużyć zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 33: „Czy w § 4 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź 33: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 34: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 1 % wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu.

Odpowiedź 34: Zamawiający ustalił brzmienie ww. postanowienia umowy w odpowiedzi na pytanie nr 25.

Pytanie 35: „Wnosimy o wykreślenie zapisu w § 10 ust 2: <<celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykatyjną.>>”

Odpowiedź 35: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 36: „**Dotyczy: Pakiet 8 Stenty uwalniające lek antyprofilakcyjny – sirolimus lub pochodny** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów uwalniających lek antyprofilakcyjny – sirolimus:

- profil przejścia (ang.crossing profile) dla stentu o średnicy 3mm:0.035”
- RBP 15 – 18 atm.
- maksymalna średnica stentu – 4,0 mm

Pozostałe parametry i skład pakietu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 12 i 29 dokonał już modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla ww. pakietu – jego aktualne brzmienie (uwzględniające odpowiedź na niniejsze pytanie) określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 37: „**Dotyczy: Pakiet 9 Cewniki balonowe półpodatne** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych półpodatnych

- wytrzymałość ciśnieniowa balonu 14 atm i 18 atm dla średnic 1,25 ; 1,5mm
- maksymalna średnica 4,0 mm

Pozostałe parametry i skład pakietu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 4, 13 oraz 30 dokonał już modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla ww. pakietu – jego aktualne brzmienie (uwzględniające odpowiedź na niniejsze pytanie) określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją formularza cenowego.

Pytanie 38: „**Dotyczy: Pakiet 20 Stenty do bifurkacji wieńcowych powlekane sirolimusem lub pochodnym** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów do bifurkacji wieńcowych powlekanych sirolimusem:

- Ciśnienie RBP 18 atm, dla średnicy 4,0 – 15 amt.

Pozostałe parametry i skład pakietu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 38: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu.

Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy się posłużyć zaktualizowanym formularzem cenowym.

Pytanie 39: „**Dotyczy: Pakiet 24 cewnik balonowy pokrywany substancją antymitotyczną do angioplastyki tętnic wieńcowych** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie balonowego pokrywanego substancją antymitotyczną do angioplastyki tętnic wieńcowych:

- Dostępne w 6 średnicach: 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 [mm]

Pozostałe parametry i skład pakietu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź 39: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla tego pakietu.

**Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Sporządzając ofertę należy się posłużyć zaktualizowanym formularzem cenowym.**

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, natomiast przedłużeniu ulega termin składania ofert - do dnia 01.10.2014 r. do godziny 10.00. Stosownemu przedłużeniu ulegają wszystkie terminy określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załączniki:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 24, 27 – aktualne brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.