

LAS-540/1-PN/17-2015

Rybnik, dnia 15.07.2015 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów z włóknin medycznych  
(zamówienie nr LAS-540-PN/17-2015)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 17.06.2015 r., nr 2015/S 115-208173

**W związku z wniesionymi przez wykonawcę zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

**Pytanie 1:** „Pakiet 21, L.p. 1 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych o obwodzie w pasie 150-170 cm?”

**Pytanie 2:** „Pakiet 21, L.p. 3 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 2-6 kg?”

**Pytanie 3:** „Pakiet 21, L.p. 4 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 8-16 kg?”

**Pytanie 4:** „Pakiet 21, L.p. 6 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 4-10 kg?”

**Odpowiedź 1 - 4:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniach. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla pakietu nr 21.

Zmodyfikowany formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma – sporządzając ofertę należy się posłużyć zaktualizowanym formularzem cenowym.

**Pytanie 5:** „Wzór umowy -§ 1 pkt. 4 – Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb, tym samym dopuszcza ograniczenie zamówienia w zakresie ilościowym, nie wskazując, rzeczywistego gwarantowanego zakresu zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie niniejszej umowy. Brak wskazania ograniczenia ilościowego, może doprowadzić do sytuacji, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zamówi np. tylko 10% ilości asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Tak sformułowany zapis powoduje, iż Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo określić ceny jednostkowej oferowanych produktów. Jaka minimalną ilość asortymentu (określoną procentowo) Zamawiający zamierza zamówić w okresie trwania umowy?”

**Odpowiedź 5:** Zamawiający wprowadza następującą modyfikację nadając nowe brzmienie dla § 1 ust. 4: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Ograniczenie do 70% przedmiotu umowy nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych”.

#### Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

**Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765**

**Pytanie 6:** „Pakiet 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w kolorze fioletowym z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m kw. Pozostałe wymagania zgodnie z siwz ?”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o gramaturze określonej w pytaniu.

**Pytanie 7:** „Pakiet 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców o rozmiarze 126x215 cm (rozmiar całkowity pokrycia) ?”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach określonych w pytaniu.

**Pytanie 8:** „(Pakiet 11) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy?”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy.

**Pytanie 9:** „Czy Zamawiający wymaga żeby w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 w zestawie do angiografii udowo – promieniowej zgodnie z nowymi przepisami epidemiologicznymi były 2 sztuki narzędzi do dezynfekcji pola operacyjnego.”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


**Pytanie 10:** „Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 w zestawie do angiografii udowo – promieniowej warstwa chłonna wykonana była z czterowarstwowego laminatu o gramaturze min. 105g/m<sup>2</sup> i strukturze plastra miodu, charakteryzująca się wchłanianością materiału biologicznego w całości i posiadająca zastawki, dzięki którym zewnętrzna warstwa wzmocnienia pozostaje sucha.”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu, ale nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 11:** „dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 serweta 75 x 80 cm
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm z otworem 9 x 15cm




**Odpowiedź 11:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 12:** „dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przyklepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
- (2 -warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm




- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2 -warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 13:** „dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 1 niżej opisanego zestawu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)”




**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 14:** „dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 2 niżej opisanego zestawu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 2 ręczniki do rąk
- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami, perforowana końcówka
- 1 osłona na nogę 36 x 65 cm
- 1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm”



**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 15:** „dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 ubrań chirurgicznych w rozmiarach S-XL w kolorze niebieskim, pakowanych osobno spodnie i koszule, co znacznie ułatwia dobór rozmiaru?”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 16:** „dotyczy Pakietu nr 15-16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia w pakiecie nr 15 i 16 jednego pełnego opakowania handlowego (zbiorczego – kartonu)? Opakowanie zbiorcze fartuchów chirurgicznych zawiera 20 szt fartuchów, natomiast opakowanie zbiorcze ubrań

chirurgicznych zawiera po 30 szt koszul i spodni. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, prosimy o podanie jakiej ilości sztuk należy dostarczyć w formie próbek."

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie odstępuje od ww. wymogów. Jednocześnie zamawiający podkreśla, że oczekuje złożenia próbek w formie asortymentu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. odpowiednio do wymagań określonych w danym pakiecie (w tym w szczególności - z zachowaniem wymagań dotyczących sterylności).

Ponadto zamawiający dokonuje korekty brzmienia opisu w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” dla pozycji 1 pakietu nr 15 poprzez wykreślenie w cytowanym fragmencie omyłkowo wklejonych słów – jak niżej:

~~„Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy/ rzepu wielokro18. Pismo otrzymane od wykonawcy: Promed S.A. (datowane na dzień: 21.01.2015 r.) – prośba o przesłanie zbiorczego zestawienia złożonych ofert.tnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartucha”~~


**Pytanie 17: „dotyczy Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 fartucha jednorazowego użytku w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 x 140 cm?”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu spełniającego pozostałe wymagania i jednocześnie wyjaśnia, że pod pojęciem „rozmiar uniwersalny” zamawiający rozumie zaoferowanie asortymentu w rozmiarze wystarczającym do zabezpieczenia odzieży wierzchniej przed zabrudzeniem osób o różnym wzroście.

**Pytanie 18: „Pakiet nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu urologicznego posiadającego serwetę na stolik instrumentariuszki o wym. 120 x 140 cm oraz serwetę o wym. 90 x 175 cm z otworem 9 x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ



**Odpowiedź 18:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy.

**Pytanie 19: „Pakiet nr 5, poz. 1**


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ginekologicznych o składzie:

- 1 serwetka na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm
- 2 ręczniki celulozowe o wym. 30 x 40 cm
- 1 serwetka na stolik Mayo o wym. 80 x 145 cm
- 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24 cm
- 1 serwetka samoprzylepna (folia PE) 50 x 50 cm
- 1 serwetka ginekologiczna o wym. 240/260 x 230 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 1-3. Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Obłożenie wykonane w całości z 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Elementy zestawu posiadają oznakowanie w formie piktogramów




umożliwiających sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu podwójne opakowanie, w tym zewnętrzne opakowanie kartonowe.



**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 20:** „*Pakiet nr 10, poz. 1*

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ręki i przedramienia bez 2 ręczników? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*



**Odpowiedź 20:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu do operacji ręki i przedramienia bez ręczników, dopuszcza natomiast zaoferowanie tego zestawu z ręcznikami pakowanymi osobno. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 21:** „*Pakiet 10, poz. 1*

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ręki i przedramienia z 2 ręcznikami pakowanymi osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

**Odpowiedź 21:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 20.

**Pytanie 22:** „*Pakiet 11, poz. 1*

[illegible]

**Pytanie 23: „Pakiet 12, poz. 1**

Technical drawing of a book cover showing front, back, and spine views with dimensions in cm.

**Front View (Top Left):** A rectangle with a width of 190 cm and a height of 150 cm. It features a light blue border at the top and bottom, and a dark green central panel.

**Back View (Bottom Left):** A rectangle with a width of 145 cm and a height of 80 cm. It features a dark green central panel and a light blue border on the right side.

**Spine View (Bottom Left):** A rectangle with a width of 55 cm and a height of 30 cm. It features a light blue border on the left and right sides, and a dark green central panel.

**Spine View (Bottom Left):** A rectangle with a width of 50 cm and a height of 0 cm.


**Back View (Bottom Center):** A rectangle with a width of 150 cm and a height of 180 cm. It is a solid light blue rectangle.

**Spine View (Right):** A rectangle with a width of 225 cm and a height of 320 cm. It is a solid light blue rectangle. A small dark green rectangle is centered on the spine, with a width of 7 cm and a height of 7 cm. The text "Otwór 7 cm" is written above the rectangle.

strona 6 z 36

**Odpowiedź 24:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 23.

**Pytanie 25:** „**Pakiet 12, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii owiniętego w serwetę celulozowo-foliową o wym. 80 x 100 cm i gram.42 g/m<sup>2</sup> (zamiast serwety na stolik instrumentariuszki)? Obłożenie wykonane w całości z 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

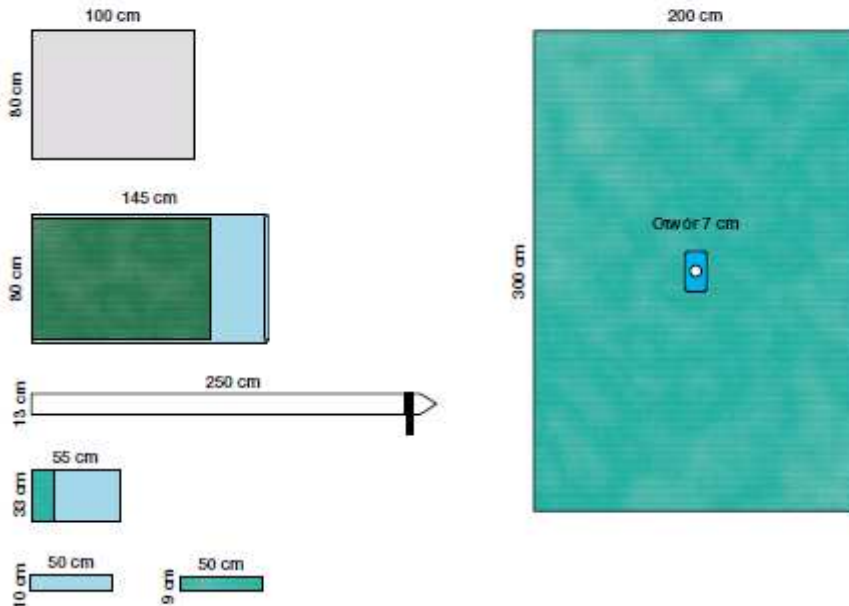

**Odpowiedź 25:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.


**Pytanie 26:** „**Pakiet 12, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii z serwetą na stolik instrumentariuszki pakowaną osobno? Obłożenie wykonane w całości z 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne SIWZ”

**Odpowiedź 26:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 27:** „**Pakiet 13, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy/szyi o składzie:


- 1 serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm
- 4 ręczniki celulozowe o wym. 30 x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo o wym. 80 x 145 złożoną nie teleskopowo
- 1 serweta o wym. 75 x 90 cm
- 1 serweta samoprzylepne o wym. 75 x 90 cm
- 1 serweta operacyjna o wym. 150 x 250 cm z wycięciem 10 x 80 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 1-3. Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Obłożenie wykonane w całości z 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Elementy zestawu posiadają oznakowanie w formie piktogramów umożliwiających sprawne rozłożenie zestawu i obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu podwójne opakowanie, w tym zewnętrzne opakowanie kartonowe .



**Odpowiedź 27:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 28:** „*Pakiet 13, poz. 2* Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych posiadającego serwetę operacyjną o wym. 200 x 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



**Odpowiedź 28:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 29:** „*Pakiet 15, poz. 1,2*

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów, które posiadają przy szyi szerokie i długie zapięcia na rzep - dł. 6,5 cm i 14 cm, szer. 3 cm (zamiast taśmy wielokrotnego użytku) i umożliwiają głębokie założenie na siebie tylnych części fartucha i uzyskanie pełnej sterylności tylnej powierzchni fartucha? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 29:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 30:** „*Pakiet 15, poz. 2*



Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów, które posiadają dodatkowo 2 ręczniki celulozowe? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź 30:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 31:** „**Pakiet 16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów dostępnych tylko w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź 31:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 32:** „**Pakiet 18, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów niesterylnych w jednym rozmiarze uniwersalnym?”

**Odpowiedź 32:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 20.

**Pytanie 33:** „**Dot. Pakietu 5, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych w następującym składzie:

serweta z otworem prostokątnym 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej	1szt.	245x180cm
serweta przeznaczona pod pośladki	1szt.	90x75cm
taśma medyczna	2szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stół Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 33:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 34:** „**Dot. Pakietu 5, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych:

serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirurgiczną, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1szt.	260x240cm
serweta przeznaczona pod pośladki	1szt.	90x75cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
kieszeń na płyny	1szt.	42x35cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stół Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.”

**Odpowiedź 34:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 35:** „Dot. Pakietu 7, poz. 1:

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:*

- 1 szt. serwety do okrycia noworodka o wym. 80 x 60cm
- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny z materiału SMS o gram 35 g/m2, rozmiar L, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;
- 4 szt. ręczniki z chłonnej włókniny kompresowej o wym. 20 x 40cm

*Pozostałe składowe zestawu oraz jego parametry pozostaną bez zmian.”*

**Odpowiedź 35:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 36:** „Dot. Pakietu 7, poz. 2:

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:*

- 1 serweta do cięcia cesarskiego o wym. 180x320cm, z workiem na płyny 360 stopni oraz oknem o wym. min. 28 x 19cm wypełnionym folią chirurgiczną,
- 1 chłonny podkład dla noworodka o wym. 60 x 90 cm
- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony z materiału SMS o gram 35 g/m2 (wzmocnienie PP+PE - 40g/m2), rozmiar L, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;
- 2 szt. sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony z materiału SMS o gram 35 g/m2 (wzmocnienie PP+PE 40g/m2), rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;

*Pozostałe składowe zestawu oraz jego parametry pozostaną bez zmian.”*

**Odpowiedź 36:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 37:** „Dot. Pakietu 8, poz. 1:

*Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy/universalny o składzie:*

serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
serweta z przylepcem	1szt.	180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2szt.	90x75cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

*Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m2.*

**lub**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy/universalny o składzie:*

serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
serweta z przylepcem	1szt.	180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2szt.	90x75cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

*przy czym materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.”*

**Odpowiedź 37:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 38: „Dot. Pakietu 8, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z fartuchami o składzie:

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 150 x 190 cm
- 2 szt. ręczniki z chłonnej włókniny kompresowej o wym. 20 x 40cm
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny wzmocniony w części krytycznej (przód fartucha i rękawy do wysokości łokcia) laminatem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, w części mniej krytycznej z włókniny oddychającej typu SMS o gram. 35 g/m<sup>2</sup>, rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwi użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;
- 2 szt. sterylne fartuch chirurgiczny wzmocniony w części krytycznej (przód fartucha i rękawy do wysokości łokcia) laminatem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, w części mniej krytycznej z włókniny oddychającej typu SMS o gram. 35 g/m<sup>2</sup>, rozmiar L, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwi użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;”

**Odpowiedź 38:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 39: „Dot. Pakietu 8, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków kończyn dolnych o składzie:

serweta z wycięciem „U” 7x63cm i przylepcem	1szt.	240x180cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x180cm
serweta	1szt.	200x180cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>.

**lub:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków kończyn dolnych o składzie:

serweta z przylepcem w wycięciu „U” 20x100cm	1szt.	260x240cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
pokrowiec na nogę	1szt.	120x37cm
kieszka na płyny z kształtką	1szt.	40x30cm
taśma medyczna	6szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>.

**lub:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków kończyn dolnych o składzie:

serweta z przylepcem w wycięciu „U” 20x100cm	1szt.	260x240cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
pokrowiec na nogę	1szt.	120x37cm
kieszka na płyny z kształtką	1szt.	40x30cm
taśma medyczna	6szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

przy czym materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 39:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 40:** „Dot. Pakietu 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji ręki i przedramienia o składzie:

serweta w kształcie litery T z otworem o śr. 5cm i elementem elastycznym	1 szt.	260x240cm
taśma medyczna	1 szt.	50x9cm
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1 szt.	75x37cm
serweta na stół instrum.	1 szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2 szt.	40x20cm

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>.

lub:

serweta w kształcie litery T z otworem o śr. 5cm i elementem elastycznym	1 szt.	260x240cm
taśma medyczna	1 szt.	50x9cm
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1 szt.	75x37cm
serweta na stół instrum.	1 szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4 szt.	40x20cm

przy czym materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.”

**Odpowiedź 40:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 41:** „Dot. Pakietu 10, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy o składzie:

serweta z elementem elastycznym i otworem o śr. 4cm	1 szt.	300x240cm
serweta na stół instrum.	1 szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4 szt.	40x20cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 42:** „Dot. Pakietu 11, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów chirurgii biodra o składzie:

serweta z przylepcem	1 szt.	260x240cm
serweta z przylepcem	1 szt.	240x150cm
pokrowiec na nogę	1 szt.	120x37cm
kieszonka na płyny z kształtką	1 szt.	40x30cm
taśma medyczna	6 szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1 szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80cm



serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm
---	-------	---------

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>.

**lub:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów chirurgii biodra o składzie:

serweta z przylepcem w wycięciu „U” 20x100cm	1szt.	260x240cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
pokrowiec na nogę	1szt.	120x37cm
kieszek na płyny z kształtką	1szt.	40x30cm
taśma medyczna	6szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

przy czym materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw

(folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 42:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 43:** „**Dot. Pakietu 12, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego o składzie:

serweta z otworem elastycznym o śr. 6cm	1szt.	320x240cm
pokrowiec na nogę	1szt.	75x37cm
taśma medyczna	2szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 43:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 44:** „**Dot. Pakietu 12, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii o składzie:

serweta z otworem elastycznym (śr. 6cm) i workiem z kształtką do zbierania płynów	1szt.	320x240cm
pokrowiec na nogę	1szt.	75x37cm
taśma medyczna	2szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm
osłona na kamerę	1szt.	13x244cm

Osłona na kamerę będzie dostarczana osobno do każdego zestawu w wersji sterylnej. Jej cena będzie wliczona w cenę całego zestawu do artroskopii.

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 44:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 45: „Dot. Pakietu 12, poz. 2:**

*Czy Zamawiający potwierdza, że w zestawie do artroskopii serweta główna do operacji kończyny nie ma posiadać wbudowanego worka do zbierania płynów?*

*Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:*

serweta z otworem elastycznym o śr. 6cm	1szt.	320x240cm
pokrowiec na nogę	1szt.	75x37cm
taśma medyczna	2szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stół Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm
osłona na kamerę	1szt.	13x244cm

*Osłona na kamerę będzie dostarczana osobno do każdego zestawu w wersji sterylnej. Jej cena będzie wliczona w cenę całego zestawu do artroskopii.*

*Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź 45:** Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania serwety głównej do operacji kończyny bez wbudowanego worka do zbierania płynów. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o cechach opisanych w powyższym pytaniu.

**Pytanie 46: „Dot. Pakietu 13, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji głowy/szyi o składzie:

serweta z wycięciem „U” 7x63cm i przylepcem	1szt.	240x150cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x180cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stół Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm

**Pozostałe parametry bez zmian.**

**Odpowiedź 46:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 47: „Dot. Pakietu 13, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji laryngologicznych o składzie:

serweta operacyjna z otworem owalnym 8x6cm w 1/3 długości serwety i przylepcem wokół otworu	1szt.	210x150cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stół Mayo	1szt.	145x80cm

**Odpowiedź 47:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 48: „Dot. Pakietu 15, poz. 1, 2:** Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS przy fartuchach chirurgicznych? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych

dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókny, a nie od przebiegu samego procesu.”

**Odpowiedź 48:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 49:** „Dot. Pakietu 15, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych sterylnych pełnobarierowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókny polipropylenowej typu SMS bezwzględnie spełniającego wymogi normy EN 13795 1-3. Fartuchy mocowane są przy szyi za pomocą szerokiego rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki z chłonnej włókny kompresowej o wym. 20 x 40cm. Pozostałe parametry pozostają zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź 49:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 50:** „Dot. Pakietu 15, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych sterylnych pełnobarierowych fartuchów chirurgicznych do długich zabiegów, wykonanych z włókny polipropylenowej typu SMS bezwzględnie spełniającego wymogi normy EN 13795 1-3. Fartuchy mocowane są przy szyi za pomocą szerokiego rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha. Wewnątrz opakowania dodatkowo 2 ręczniki z chłonnej włókny kompresowej o wym. 20 x 40cm. Pozostałe parametry pozostają zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź 50:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 51:** „Dot. Pakietu 16, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletów chirurgicznych dostępnych w dwóch kolorach – niebieskim oraz purpurowym/fioletowym? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź 51:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 31.

**Pytanie 52:** „Dot. Pakietu 24, poz. 1: Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia jako serwety 2-warstwowe oczekuje zaoferowania serwet nieprzemakalnych?”

**Odpowiedź 52:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań co do zakresu opisanego w pytaniu.

#### **Pytania 53-57 Do projektu umowy:**

**Pytanie 53:** „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?”

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.”

**Odpowiedź 53:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 5.

**Pytanie 54:** „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: <<Ponadto strony dopuszczają podwyższenie lub

obniżenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.>>?

*Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy."*

**Odpowiedź 54: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie 55:** „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo <<opóźnienia>> zostało zastąpione słowem <<zwłoki>>?

*Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny."*

**Odpowiedź 55: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie 56:** „Jak należy rozumieć zwrot użyty w § 5 ust. 1 wzoru umowy: <<wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu>>? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa <<wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu>> zostały zastąpione słowami <<wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka>>?

*Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy."*

**Odpowiedź 56: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 wzoru umowy odnosi się do wartości dostawy brutto objętej danym zamówieniem, a nie do wartości pakietu.**

**Pytanie 57:** „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: <<Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b, c lub d Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.>>?

*Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.*

*Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.*

*Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, <<mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone>>. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach."*



**Odpowiedź 57:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 58:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści sterylny zestaw urologiczny TUR w następującym składzie:

- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe w rozmiarze  $\varnothing 7$  cm oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza w rozmiarze 7x10 cm i bezłateksową osłonę na palec w rozmiarze  $\varnothing 3$ cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?”

**Odpowiedź 58:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 59:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 sterylny zestaw do operacji ginekologicznych zamiast 4 sztuk - dopuści 2 ręczniki celulozowe, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?”

**Odpowiedź 59:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 60:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 5 w pozycjach nr 1 oraz 2 uzna za spełnienie wymogów Zamawiającego dotyczących gramatury materiału i wzmocnienia tj. materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m<sup>2</sup> i łącznej gramaturze obszaru wzmocnionego min. 110 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź 60:** Zamawiający wyjaśnia, że opisana w pytaniu charakterystyka przedmiotu zamówienia jest zgodna z wymaganiami zamawiającego.

**Pytanie 61:** „Zwracamy się z zapytaniem czy z pakietu nr 8 wydzieli pozycję nr 1 do osobnego pakietu np. 8A? Pozwoli to na otrzymanie Zamawiającemu większej ilości ofert z bardziej korzystnymi cenami.”

**Odpowiedź 61:** Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

**Pytanie 62:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 uzna za spełnienie wymogów Zamawiającego dotyczących gramatury materiału i wzmocnienia tj. materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m<sup>2</sup> i łącznej gramaturze obszaru wzmocnionego min. 110 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź 62:** Zamawiający wyjaśnia, że opisana w pytaniu charakterystyka przedmiotu zamówienia jest zgodna z wymaganiami zamawiającego.

**Pytanie 63:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 10 w pozycjach nr 1 oraz 2 uzna za spełnienie wymogów Zamawiającego dotyczących gramatury materiału i wzmocnienia tj. materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m<sup>2</sup> i łącznej gramaturze obszaru wzmocnionego min. 110 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź 63:** Zamawiający wyjaśnia, że opisana w pytaniu charakterystyka przedmiotu zamówienia jest zgodna z wymaganiami zamawiającego.

**Pytanie 64:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 dopuści sterylne zestawy do operacji ręki i przedramienia posiadający w swoim składzie w miejsce serwety do obłożenia ręki w kształcie litery T z wbudowanym nakryciem stolika bocznego do ułożenia kończyny, o min wymiarach 270 x 350 cm, z samouszczelniającym się otworem o min śr 3 cm i wzmocnieniem - serwetę do obłożenia ręki w kształcie litery T z wbudowanym nakryciem stolika bocznego do ułożenia kończyny, o min wymiarach 270 x 320 cm, z samouszczelniającym się otworem o min śr 3 cm i wzmocnieniem, reszta parametrów zgodna z wymaganiami Zamawiającego?”

**Odpowiedź 64:** Zamawiający nie zmienia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie zamawiający wskazuje, że serweta „o min wymiarach 270 x 320 cm” spełni wymagania zamawiającego pod warunkiem, że drugi z podanych wymiarów będzie co najmniej równy 350 cm.

**Pytanie 65:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1 uzna za spełnienie wymogów Zamawiającego dotyczących gramatury materiału i wzmocnienia tj. materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze materiału 53 g/m<sup>2</sup> i łącznej gramaturze obszaru wzmocnionego min. 110 g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź 65:** Zamawiający wyjaśnia, że opisana w pytaniu charakterystyka przedmiotu zamówienia jest zgodna z wymaganiami zamawiającego.

**Pytanie 66:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 12 w pozycji nr 1 dopuści sterylne zestawy do operacji kończyny/stawu kolanowego w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
  - 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem w rozmiarze 5x7cm z uchwytem („rzepem”) do mocowania kabli i drenów
  - 1 serweta o wymiarach min. 150x150cm
  - 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
  - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
  - 2 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm ?”

**Odpowiedź 66:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 67:** „Zwracamy się z zapytaniem czy z pakietu nr 12 wydzieli pozycję nr 1 do osobnego pakietu np. 12A? Pozwoli to na otrzymanie Zamawiającemu większej ilości ofert z bardziej korzystnymi cenami.”

**Odpowiedź 67:** Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

**Pytanie 68:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 15 w pozycjach nr 1 oraz 2 dopuści jednorazowe wzmocnione, sterylne pełnobarierowe fartuchy chirurgiczne posiadające w swoim składzie - 2 ręczniki z włókniny wiskozowej typu Spunlace, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?”

**Odpowiedź 68:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w pozycji nr 1 asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - jednorazowe wzmocnione, sterylne pełnobarierowe fartuchy chirurgiczne wymagane są jedynie w poz.nr 2 pakietu nr 15, natomiast zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 2 dodatkowo 2 ręczników z włókniny wiskozowej typu Spunlace .

**Pytanie 69:** „Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 16 w pozycji nr 1 dopuści jednorazowy niesterylne komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) dostępny tylko w kolorze niebieskim, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?”

**Odpowiedź 69:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 31.

**Pytanie 70:** „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych § 3 w wysokości 0,2% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu.**”

Odpowiedź 70: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

**Pytanie 71:** „**PAKIET NR 2 Poz. nr 1** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu urologicznego TUR posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 100 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.”

Odpowiedź 71: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy.

**Pytanie 72:** „**PAKIET NR 4 Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów okulistycznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże nie posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki lub zestawu spełniającego wymogi SIWZ, jednakże bez podłokietników?”

Odpowiedź 72: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu nie zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki lub zestawu bez podłokietników. Dopuszcza natomiast zaoferowanie zestawu z podłokietnikami pakowanymi osobno – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 73:** „**PAKIET NR 6 Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia przewodowego owiniętego w papier krepowy ( zamiast w serwetę instrumentariuszki )? Pozostałe parametry i skład bez zmian.”

Odpowiedź 73: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 74:** „**PAKIET NR 6 Poz. nr 4-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów, który nie jest owinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki? Pozostałe parametry i skład bez zmian.”

Odpowiedź 74: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 75:** „**PAKIET NR 13 Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych posiadającego w swoim składzie serwetę operacyjną (z otworem) w rozmiarze 170 x 250 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.”

Odpowiedź 75: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem -

modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 76: „PAKIET NR 14 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z wycięciem U w rozmiarze 10 x 60 cm? Pozostałe parametry bez zmian”**

**Odpowiedź 76:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy.

**Pytanie 77: „PAKIET NR 20 Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski 4-warstwowej? Pozostałe parametry bez zmian**

**Odpowiedź 77:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 78: „PAKIET NR 4 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów okulistycznych posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 160 cm?”**

**Odpowiedź 78:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 79: „Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:**

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm

Serweta w górnej części wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, a w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzuszny o śred. 3 cm i kroczywym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

1 szt.

Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier- folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

**Odpowiedź 79:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 80: „Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:



Serweta okulistyczna o wym. 100 cm x 100 cm  
Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z otworem z folią operacyjną o wym. 10 cm x 10 cm, kieszeń na płyny, 2 - ma sztywniakami  
Wraz z osobno pakowaną osłoną na podłokietnik 2-warstwowa o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>.  
Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%.  
Posiada jedną taśmę przylepną  
Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiar 35 cm x 75 cm, 2 szt, opakowanie papier – folia  
Całość w opakowaniu foliowym.

**Odpowiedź 80: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.**

**Pytanie 81:** „Pakiet 6 Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę”

**Odpowiedź 81: Zamawiający dopuści takie zestawy, pod warunkiem spełniania wymogów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych.**

**Pytanie 82: „Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

- z narzędziem do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste – dł 14 cm
- z tupferami z gazy bawełnianej 20 nitkowej o min. wym. 20x 20cm lub 30x30cm?

Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.”

**Odpowiedź 82: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z tupferami z gazy bawełnianej 20-nitkowej wym. 30 x 30 cm – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 83: „Pakiet 6, poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by elementy zestawu posiadały oznakowania w formie piktogramów?”**

**Odpowiedź 83: Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania przez elementy zestawu oznakowań w formie piktogramów.**

**Pytanie 84: „Pakiet 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw z:**

- pęseta plastikowa anatomiczna – dł. 13 cm
- .- serweta włókninową dwuwarstwową, nieprzylepną o min wym. 50 cm x 70 cm, min gramatura 53 g/m<sup>2</sup>,

1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna o min wym. 50 cm x 75 cm z otworem i min gramaturze 53g/m<sup>2</sup>

- opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm (zapakowany), zestaw zapakowany w opakowanie papier-folia?

Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.”

**Odpowiedź 84: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym**

wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 85: „Pakiet 6, poz. 3** Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

*serweta na stół narzędziowy- 120x90cm*

*tampony z gazy bawełnianej min 20x 20cm lub 30x30cm*

*igła– 0,7x40mm*

*igła – 0,8x40mm*

*1 szt. serweta włókninowa dwuwarstwowa samoprzylepna wokół otworu 10 cm o min wym. 120x90 cm,*

*1 szt. kleszczyki plastikowe typu korcang. 18cm*

*1 szt. fartuch chirurgiczny L, 1 szt. opatrunek z folii poliuretanowej 10cmx15cm?*

*Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.”*

**Odpowiedź 85:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 86: „Pakiet 6, poz. 3** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by elementy zestawu posiadały oznakowania w formie piktogramów?”

**Odpowiedź 86:** Zamawiający nie odstępuje od wymogu posiadania przez elementy zestawu oznakowań w formie piktogramów.

**Pytanie 87: „Pakiet 6, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

*igłotrzymaczem metalowy 15cm?*

*Pozostałe składowe ilości i parametry zestawu bez zmian.”*

**Odpowiedź 87:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 88: „Pakiet 7, poz. 1**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*2 x Serweta o wym. 90 cm x 120 cm*

*Serweta dwuwarstwowa (włóknina + lamina. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%*

*2 x Podkład chłonny o wym. 60 cm x 90 cm*

*Podkład chłonny, 5 warstwowy składających się z warstw: lamiantu, waty celulozowej, pulpy celulozowej, waty celulozowej, włókniny polipropylenowej. Kolor laminatu zielony lub niebieski. Gramatura 160 g/m<sup>2</sup>. Chłonność 0,152 ml/cm<sup>2</sup>.*

*1x Serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm*

*Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> ± 5 g/m<sup>2</sup>*

*6 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm*

*Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>*

*Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.*

*Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.*

*Do powyższego zestawu dołączony osobno pakowany jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m<sup>2</sup>. Wykonany z włókniny SSMMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm*

na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesieknięcie płynów 40,5 cm H<sub>2</sub>O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L  
Całość w opakowaniu foliowym."

**Odpowiedź 88:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 89: „Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Do powyższego zestawu dołączony osobno pakowany zestaw: 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Całość w opakowaniu foliowym."

**Odpowiedź 89:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 90:** „**Pakiet 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

**Odpowiedź 90:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 91: „Pakiet 8, poz. 1**

*Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”*

**Odpowiedź 91:** Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

**Pytanie 92: „Pakiet 9**

*Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:*

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

*Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę”*

**Odpowiedź 92:** Zamawiający dopuści takie zestawy, pod warunkiem spełniania wymogów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych.

**Pytanie 93: „Pakiet 10, poz. 1**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:*

*1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm*

*Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.*

*1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm*

*Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.*

*Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.*

*Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.*

*Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.*

*Chłonność serwety 350%.*

*1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm*

*Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup> z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.*

*1 x Serweta o wym. 160 x 180cm*

*Serweta samoprzylepna. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.*

*1 x Taśma przylepna 10 x 50cm*

*4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm*

*Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>*

*Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.*

*Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce*

znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

**Odpowiedź 93:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 94:** „**Pakiet 10, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw serwet do operacji barku

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 75x50cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 150x180cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonną o wym. 80x50cm i 1dnym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm

Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

**Odpowiedź 94:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 95:** „**Pakiet 11, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 cm x 260 cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m<sup>2</sup>. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta 170 cm x 240 cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m<sup>2</sup>. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 35 cm x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

**Odpowiedź 95:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 96:** „**Pakiet 12, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m<sup>2</sup>. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>



Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

**Odpowiedź 96:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 97:** „**Pakiet 12, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta dwuwarstwową (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwową (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min 75x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwową. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

**Odpowiedź 97:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 98:** „**Pakiet 13, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwową (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety 63g/m<sup>2</sup>. Boki serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>.

Całkowity rozmiar serwety 150 cm x 190 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 65 cm x 190 cm. Chłonność 350%

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140 cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwową (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 108g/m<sup>2</sup>. Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 150 cm x 200 cm

Wycięcie U przylepne o wym. 6 cm x 65 cm. Serweta z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m<sup>2</sup>. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta z przylepcem. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta z przylepcem. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

**Odpowiedź 98:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 99:** „**Pakiet 13, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta o wym. 200 cm x 280 cm

Serweta z otworem Ø 10 cm przylepnym, z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m<sup>2</sup>. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

**Odpowiedź 99:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 100:** „**Pakiet 14, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści serwety wycięciem U wym. wycięcia 65 cm x 6 cm, spełniające pozostałe wymagania w siwz?"

**Odpowiedź 100:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 101:** „*Pakiet 14, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 75 cm x 90 cm , spełniające pozostałe wymagania w siwz?*”

**Odpowiedź 101:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu spełniającego pozostałe wymagania, ponieważ określone w formularzu cenowym wymiary są wymiarami minimalnymi – serweta opisana w pytaniu spełnia wymogi w zakresie rozmiaru.

**Pytanie 102:** „*Pakiet 14, poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?*”

**Odpowiedź 102:** Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

**Pytanie 103:** „*Pakiet 14, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 150 cm x 180 cm , spełniające pozostałe wymagania w siwz?*”

**Odpowiedź 103:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu spełniającego pozostałe wymagania, ponieważ określone w formularzu cenowym wymiary są wymiarami minimalnymi – serweta opisana w pytaniu spełnia wymogi w zakresie rozmiaru.

**Pytanie 104:** „*Pakiet 14, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 50 cm x 75 cm , spełniające pozostałe wymagania w siwz?*”

**Odpowiedź 104:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu spełniającego pozostałe wymagania, ponieważ określone w formularzu cenowym wymiary są wymiarami minimalnymi – serweta opisana w pytaniu spełnia wymogi w zakresie rozmiaru.

**Pytanie 105:** „*Pakiet 14, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwety/ręczniki do rąk o wym. 40 cm x 40 cm - serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> ?*

*Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier- folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”*

**Odpowiedź 105:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 106:** „*Pakiet 14, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 80 cm x 140 - serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona.*

*Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.*

*Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.*

*Gramatura serwety 80g/m<sup>2</sup>. Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE*

*o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.*

*Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej*

140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795."

**Odpowiedź 106:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 107:** „**Pakiet 14, poz. 9** Czy Zamawiający dopuści osłonę o wym. 30 cm x 80 cm , spełniające pozostałe wymagania w siwz?”

**Odpowiedź 107:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu spełniającego pozostałe wymagania, ponieważ określone w formularzu cenowym wymiary są wymiarami minimalnymi – osłona opisana w pytaniu spełnia wymogi w zakresie rozmiaru.

**Pytanie 108:** „**Pakiet 15, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m<sup>2</sup>. Wykonany z włókniny SSMMS.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiekanie płynów 40,5 cm H<sub>2</sub>O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/2. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL."

**Odpowiedź 108:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 109:** „**Pakiet 15, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m<sup>2</sup>. Wykonany z włókniny SSMMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/2. Gramatura fartucha w miejscach wzmocnionych 73 g/2.

Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiekanie płynów 40,5 cm H<sub>2</sub>O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/2. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL."

**Odpowiedź 109:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 110:** „**Pakiet 16, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści komplety o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, spełniające pozostałe wymagania w siwz?”

**Odpowiedź 110:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 111:** „***Pakiet 18, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L-XL, spełniający pozostałe wymagania w siwz?*”

**Odpowiedź 111:** Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 20.

**Pytanie 112:** „***Pakiet 20, poz. 4** Zwracam się o wyjaśnienie co jest jednostką miary w w/w pozycji?*”

**Odpowiedź 112:** Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w kolumnie „Jednostka miary” dla pakietu 20 pozycji 4 zastępując zapis „440” zapisem „szt.”

**Pytanie 113:** „***Pakiet 20, poz. 7** Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:*

- *Czepek z wstawką antypotną w części czołowej*
- *Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy*
- *Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami*
- *Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej*
- *Doskonała oddychalność i komfort użytkowania*
- *Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk*
- *Jednorazowego użytku*
- *Niejałowy*



**Odpowiedź 113:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zastrzeżeniem, iż wstawka antypotna umiejscowiona w części czołowej musi być trwale wszyta w czepek i obejmować całe czoło, od skroni do skroni – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy.

**Pytanie 114:** „***Pakiet 23, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli:*

*Poszewka 70 x 80 cm*

*Poszwa 160 cm x 210 cm*

*Prześcieradło 150 cm x 210 cm*

*spełniający pozostałe wymagania w siwz?*”

**Odpowiedź 114:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 115:** „***Pakiet 23, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli , w której kołdra ma zakładkę 15 cm, spełniający pozostałe wymagania w siwz?*”

**Odpowiedź 115:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 116:** „***Pakiet 23, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli , w której poszewka na poduszkę ma zakładkę 10 cm, spełniający pozostałe wymagania w siwz?*”

**Odpowiedź 116:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

**Pytanie 117:** „***Pakiet 23, poz. 1** Czy Zamawiający oczekuje kompletu pościeli j.u. wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35 g/m<sup>2</sup>? Jeżeli tak to prosimy o odstępianie od normy PN EN 13795 gdyż norma ta odnosi się do obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych. Fartuch j.u. niejałowy nie jest przeznaczony do stosowania na bloku operacyjnych w związku z tym wymaganie normy nie ma uzasadnienia.*”

Odpowiedź 117: Zamawiający odstępuje od żądania zaoferowania pościeli z materiału zgodnego ze wskazaną w formularzu cenowym normą, tym samym w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” należy dokonać stosownego wykreślenia. Zamawiający nie odnosi się do zapisów dotyczących fartucha – przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 23 są komplety pościeli jednorazowej.

Pytanie 118: „**Pakiet 23, poz. 1** Czy Zamawiający odstąpi o d wymogu by pościel posiadała przepuszczalność powietrza 3500-3600 g/m<sup>2</sup>/24 godz?”

Odpowiedź 118: Zamawiający nie odstępuje od tego wymagania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

Pytanie 119: „**Pakiet 25, poz. 1** Czy Zamawiający oczekuje koszul z włókniny SMS?”

Odpowiedź 119: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, poza wymienionymi w formularzu cenowym.

Pytanie 120: „**Pakiet 27, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści osłona typu "beret" na urządzenie o wymiarach 65 cm x 85 cm z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?”

Odpowiedź 120: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 121: „**Pakiet 27, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści osłona typu "beret" na urządzenie o wymiarach 85 cm x 85 cm z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?”

Odpowiedź 121: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 122: „**Pakiet 20, Pozycja 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego czepek z taśmą pochłaniającą pot jedynie w części przedniej spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?”

Odpowiedź 122: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z zastrzeżeniem, iż wstawka antypotna umiejscowiona w części czołowej musi być trwale wszyta w czepek i obejmować całe czoło, od skroni do skroni – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 123: „**Dotyczy Pakiet 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na podłokietniki pakowane osobno?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 123: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na pytanie 72.

Pytanie 124: „**Dotyczy Pakiet 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

-Serweta chirurgiczna o wymiarach 200x315cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 11x12cm otoczony warstwą chłonną. Serweta czterowarstwowa o wysokiej odporności na przenikanie cieczy: w strefie krytycznej 900cm H<sub>2</sub>O

-Taśma samoprzylepna 9x49cm 1 sztuka

-Osłona na stolik Mayo 79x145cm

-Serweta na stolik(owinięcie zestawu) 150x190cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 124: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 125: „**Dotyczy Pakiet 11 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra z :

- Serwetą chirurgiczną dolną o wymiarach 200x260cm z wycięciem „U” o wymiarach 20x102cm wzmocniona w strefie krytycznej,
  - 2 taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49cm
  - 4 ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ  
Zaproponowany zestaw jest 4 warstwowy (dodatkowa warstwa chłonna) o gramaturze 114g/m2 i posiada dodatkowo kieszeń samoprzylepną dwukomorową 40x35cm.”

**Odpowiedź 125: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.**

**Pytanie 126: „Dotyczy Pakiet 13 pozycja 2”**

*Czy Zamawiający dopuści zestaw do do operacji laryngologicznych który w składzie posiada 2 ręczniki chłonne o wymiarze 18x25cm?  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 126: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 127: „Pakiet 14 pozycja 3”**

*Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 80g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 127: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.**

**Pytanie 128: „pakiet 14 pozycja 9”**

*Czy Zamawiający dopuści sterylna osłonę na kończynę o wymiarach 22x75? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 128: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.**

**Pytanie 129: „pakiet 14 pozycja 9”**

*Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 32x120cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 129: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 130: „Pakiet 15 pozycja 1”**

*Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS oraz z zapięciem typu rzep standard? Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 130: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.**

**Pytanie 131: „Pakiet 15 pozycja 2”**

*Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS oraz z zapięciem typu rzep standard? Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”*

**Odpowiedź 131: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.**



**Pytanie 132: „Dotyczy: Pakiet 1 Zestawy kardiologiczne**

**Pozycja 1 STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW ZAKŁADANIA STYMULATORÓW SERCA**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych zestawów do zabiegów zakładania stymulatorów serca o składzie:

**1 szt.** serweta chirurgiczna (serweta główna) z samoprzylepnym otworem o wym. 14 x 25 cm

umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z 3 warstw, w strefie krytycznej zaopatrzona w dodatkową warstwę wysokochłonną o łącznej gramaturze strefy krytycznej powyżej 150 g/m<sup>2</sup>;

**1 szt.** sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMS Szwy wykonane techniką podwójnego, szczelnego szycia Rozmiar XL - Materiał fartuchów spełnia wymogi normy EN 13795 1-3

**1 szt.** sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMS Szwy wykonane techniką podwójnego, szczelnego szycia Rozmiar L - Materiał fartuchów spełnia wymogi normy EN 13795 1-3

**8 szt.** ręczniki celulozowe wzmocnione nicią poliestrową

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź 132:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 133: „Dotyczy: Pakiet 1 Zestawy kardiologiczne**

**Pozycja 2 STERYLNY ZESTAW DO ANGIOGRAFII UDOWO-PROMIENIOWEJ**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do angiografii udowo-promieniowej o składzie:

**1 szt.** serweta angiograficzna (serweta główna) składająca się z 3 warstw, w strefie krytycznej wokół otworów zaopatrzona w dodatkową warstwę wysokochłonną o łącznej gramaturze strefy krytycznej powyżej 150 g/m<sup>2</sup>;

**1 szt.** sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMS Szwy wykonane techniką podwójnego, szczelnego szycia Rozmiar XL - Materiał fartuchów spełnia wymogi normy EN 13795 1-3

**1 szt.** sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMS Szwy wykonane techniką podwójnego, szczelnego szycia Rozmiar L - Materiał fartuchów spełnia wymogi normy EN 13795 1-3

**8 szt.** ręczniki celulozowe wzmocnione nicią poliestrową

Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.”

**Odpowiedź 133:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 134: „Pakiet 14, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 14.**

*Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.”*

**Odpowiedź 134:** Zgodnie ze SIWZ Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

**Pytanie 135: „Pakiet nr 14, poz.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji osłony na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup> i folii PE o grubości 50 µm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.”**

**Odpowiedź 135:** Zamawiający nie zmienia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie zamawiający wskazuje, że osłona „o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>” spełni wymagania zamawiającego pod warunkiem, że będzie co najmniej równa 63 g/m<sup>2</sup>.

**Pytanie 136: „Pakiet nr 16, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji kompletu odzieży chirurgicznej (bluza+ spodnie). Spodnie proste, nogawki bez ściągacza, wiązane na troki. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca trzy kieszenie, zapinana na nap pod szyją i wykończona lamówką. Komplet wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS**

*o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>. Materiał spełniający normę EN 13795 1-3. Komplet dostępny w kolorze niebieskim i w rozmiarze: S, M, L, XL.”*

**Odpowiedź 136:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

**Pytanie 137:** „***Pakiet nr 22, poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu nieprzemakalnego wykonanego z chłonnej warstwy bibuły oraz warstwy folii o szerokości 50 cm, o długości rolki 50 m, tj. 880 rolek.”*

**Odpowiedź 137:** Zamawiający nie zmienia wymagań w zakresie opisanym w pytaniu – podtrzymuje wymaganie zaoferowania podkładów podfoliowanych, włókninowych.

**Pytanie 138:** „***Pakiet nr 27, poz. 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na aparaturę o średnicy 50 cm. Pokrowiec wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE o grubości 50 µm z elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.”*

**Odpowiedź 138:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań Zamawiającego – pokrowiec opisany w pytaniu spełnia wymogi w zakresie grubości folii PE.

**Pytanie 139:** „***Pakiet nr 27, poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na aparaturę o średnicy 80 cm. Pokrowiec wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE o grubości 50 µm z elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.”*

**Odpowiedź 139:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań Zamawiającego – pokrowiec opisany w pytaniu spełnia wymogi w zakresie grubości folii PE.

**Pytanie 140:** „***Pakiet nr 27, poz. 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na przewody w rozmiarze 16 cm x 200 cm. Pokrowiec, złożony teleskopowo z dodatkowymi taśmami do mocowania na końcówkach, wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE o grubości 50 µm.”*

**Odpowiedź 140:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym pytaniu pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań Zamawiającego – pokrowiec opisany w pytaniu spełnia wymogi w zakresie grubości folii PE.

**Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 23.07.2015 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Załączniki:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 21 – aktualne brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.